

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

**V/v: Khắc phục những vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn ở khu vực nội soi tiêu
hoá tại Phòng khám Đa khoa**

Kính gửi:

- Ban Lãnh Đạo Phòng khám Đa khoa;**
- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Phòng khám**

Đơn vị Nội soi tiêu hoá xin phép báo cáo tiến độ thực hiện việc khắc phục những vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn ở khu vực nội soi tiêu hoá tại Phòng khám Đa khoa theo công văn số 6027/SYT-NVY ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế.

- Khu vực xử lý dụng cụ nội soi cần biệt lập với khu vực thực hiện thủ thuật nội soi: Sau khi đoàn kiểm tra Sở Y tế yêu cầu, đơn vị đã đề xuất ngay và đã được sửa chữa xong. Hiện tại khu vực phòng xử lý dụng cụ nội soi là 1 phòng riêng, diện tích khoảng 9m², có lối đi vào từ phòng thủ thuật và đã có cửa kéo nhôm đóng mở ngăn cách riêng biệt hoàn toàn với phòng thực hiện thủ thuật.
- Quy trình xử lý dụng cụ nội soi: Dụng cụ nội soi sau khi thực hiện thủ thuật được xử lý theo “Các bước xử lý ống nội soi mềm bằng tay” theo đúng qui trình hướng dẫn trong “Hướng dẫn xử lý ống nội soi mềm trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” Quyết định số: 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 Bộ Y tế. Trong bước số 7 “tráng và làm khô” là Bom nước vô khuẩn vào các kênh để đẩy dung dịch khử khuẩn. Hiện tại đơn vị đang sử dụng nước cất vô khuẩn đựng trong can (mức độ khuyến cáo vẫn được chấp nhận) trong điều kiện Phòng Khám không có hệ thống nước RO (Nước RO- mức độ khuyến cáo lý tưởng).
- Khu vực thực hiện thủ thuật nội soi đảm bảo quy trình xử lý dụng cụ nội soi một chiều: Hiện tại phòng thủ thuật nội soi và phòng xử lý dụng cụ là 2 phòng riêng biệt có một lối đi vào phòng xử lý dụng cụ từ phòng thủ thuật (Mức độ khuyến cáo chấp nhận được). Do vậy, nếu để đảm bảo mức độ yêu cầu điều kiện lý tưởng theo nguyên tắc lối đi 1 chiều từ phòng thủ thuật vào phòng xử lý dụng cụ thì cần phải đập bỏ phần vách tường xi-măng bên ngoài hoặc mở vách kính đang ngăn phòng bên trong để tạo thêm một lối đi ra.


Do liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất của phòng khám, nên vấn đề này đơn vị Nội soi tiêu hoá xin ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo Phòng Khám và Phòng kế hoạch nghiệp vụ.

4. Dụng cụ lấy mẫu sinh thiết: Đơn vị đã đề xuất kiểm sinh thiết dùng 1 lần và đề xuất chi phí phát sinh nếu có dùng kiểm sinh thiết dùng 1 lần. Xin Ban Lãnh đạo Phòng Khám phê duyệt để được áp dụng.

Đơn vị Nội soi tiêu hoá xin báo cáo và xin chờ ý kiến chỉ đạo.


Trân trọng

PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

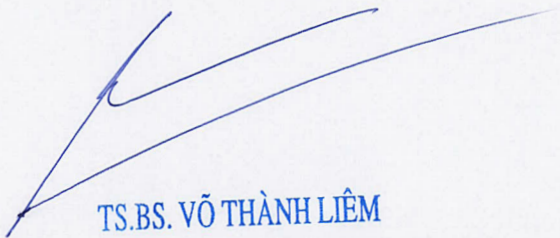

TS.BS. VÕ THÀNH LIÊM

**TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NỘI SOI TIÊU HOÁ**

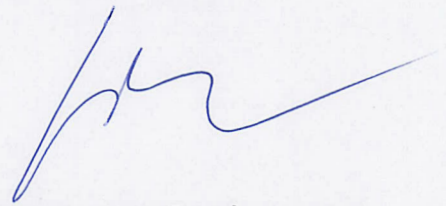

Ths.BSCK1. Nguyễn Hồng Thanh

BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

